DropSafe

safety pen needles

Agujas de seguridad para dispositivos de inyección

4S

- Seguro
- Sencillo
- Suave
- Smart

A.MENARINI diagnostics

Seguro

100% seguro
›› La aguja se encuentra dentro de una cubierta protectora, lo que evita pinchazos accidentales.

Confirmación visual de bloqueo
›› Aparece una franja roja cuando la aguja está bloqueada.

Sistema de prevención de lesiones con objetos punzantes

Sistema de bloqueo de la aguja
›› La aguja se bloquea automáticamente después del uso.

Sencillo

- **Fácil colocación ››** Compatibles con la mayoria de plumas de inyección disponibles en el mercado (según ISO 11608-2).
- **Uso intuitivo ››** Solo hay que girar, inyectar y desechar.
- **Versatil ››** Dos tamaños de aguja (31G x 6 mm, 31G x 8 mm).

es sencillo...

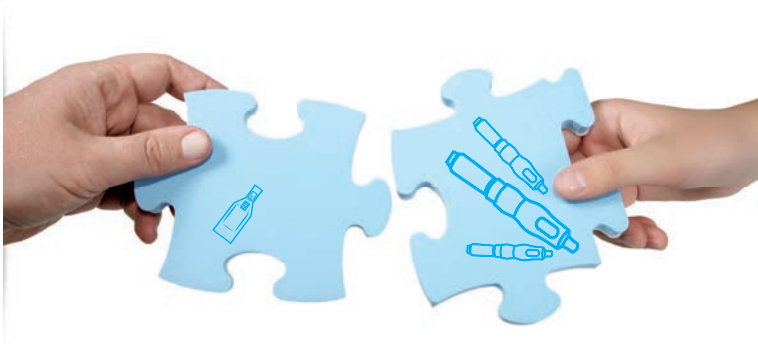

4S
Seguro
Sencillo
Suave
Smart

Suave

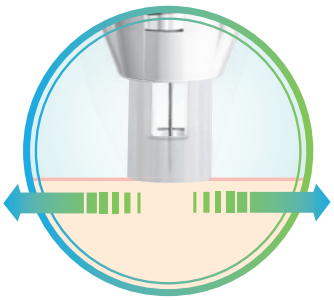

- **Suave al tacto**
  - La superficie estable de la cubierta protectora deslizante puede dispersar y reducir la presión en el lugar de inyección.

- **Cómodo de usar**
  - Método de lubricación exclusivo, Droplicon™ y triple bisel para una inyección suave y menos dolorosa.

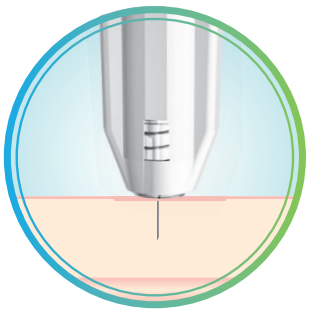

- **Aguja oculta**
  - La aguja permanece oculta, aumentando la comodidad del paciente.

Smart

- **Ventana de visualización de la aguja**
  - Permite confirmar fácilmente la carga del medicamento (cebado).

- **Calidad excepcional**
  - La pared fina permite una administración fácil y óptima del medicamento.

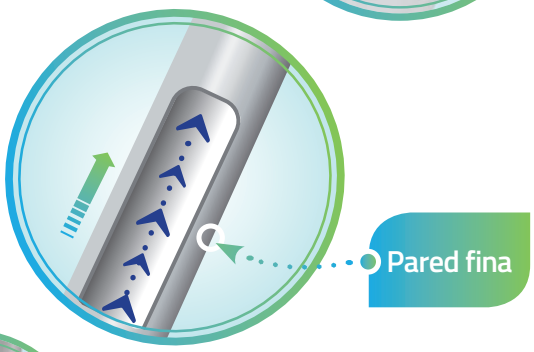

- **Libre de Látex**

- **Diseño ergonómico**
  - Diseño especial en forma de alas para un agarre cómodo y seguro.

4S
- Seguro
- Sencillo
- Suave
- Smart

DropSafe

safety pen needles

- Seguro
- Sencillo
- Suave
- Smart

Disponible en dos tamaños:

CE 0344

DropSafe 31G

(0,25mm) x 6mm,
Caja de 100 unidades

DropSafe 31G

(0,25mm) x 8mm,
Caja de 100 unidades

Instrucciones de uso

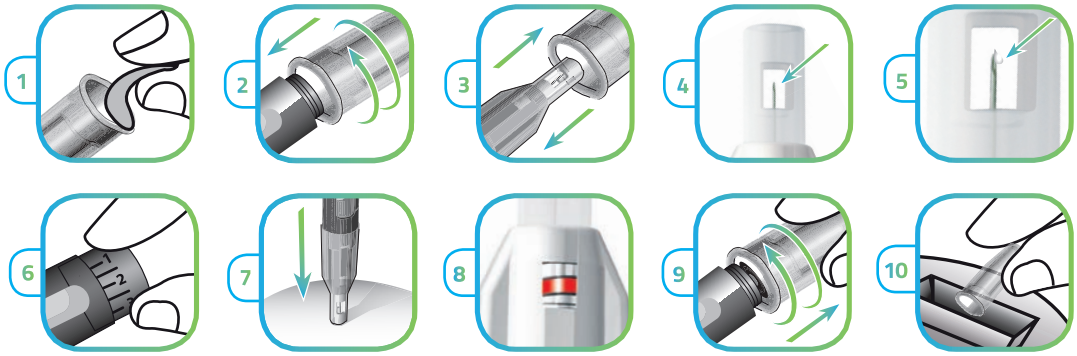

REFERENCIAS:

- HTL- STREFA S.A. – data on file - FINAL REPORT - SIMULATED CLINICAL USE TESTING ON THE DROPSAFE SAFETY PEN NEEDLE, 17 January 2017, Version 1.0.
- www.cdc.gov – Sharps Injury prevention.
- COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU.
- American Society of Health-System Pharmacists. Recommendations for Safe Use of Insulin in Hospitals https://www.ashp.org
- Greenwood B, Szumita PM, Pendergrass M. Conversion to insulin devices in the inpatient setting. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:698-699.
- Davis EM, Christensen CM, Nystrom KK, Foral PA, Destache C. Am J Health-Syst Pharm. 2008;65(14):1347–1357.
- Davis EM, Bebee A, Crawford L, Destache C. Nurse satisfaction using insulin pens in hospitalized patients. The Diabetes Educator. 2009(Sep/Oct);35(5).
- Medical Devices with Sharps Injury Prevention Features, Issued on August 9, 2005.

A.MENARINI diagnostics

Soluciones para la Diabetes
www.solucionesparaladiabetes.com

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
900 301 334

YouTube Soluciones para la Diabetes

@Soluciondiabete

Cód.: 3.100 P2593

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL SANITARIO

Distribuido por: A. Menarini Diagnostics | Fabricante: HTL-STREFA S.A.

MP19-18

Ver. 1 - Rev. 01 - PR - 07/2018